

Compudose 200

Reg. Q-0715-137

Implante anabólico de liberación controlada para su uso en Novillos, Toros y Vaquillas

FÓRMULA

Cada (implante) dosis equivale a:

Estradiol..... 25.7mg

Oxitetraciclina..... 0.5mg

FORMA FARMACÉUTICA: Implante anabólico

INGREDIENTE ACTIVO: Estradiol y Oxitetraciclina

INDICACIONES: Implante de liberación controlada, para incrementar la tasa de ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia en terneros, toros y vaquillas de engorda / engorde en pastoreo y confinamiento (feed lots).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Cada implante de Compudose 200 de liberación controlada proveerá una dosis diaria efectiva de estradiol durante por lo menos 200 días en novillos, toros y vaquillas para engorda/engorde. Compudose 200, únicamente para implantación subcutánea en la oreja de bovinos para carne (Terneros, Novillos, Toros y Vaquillas en pastoreo y confinamiento).

INSTRUCCIONES:

Inserte un implante debajo de la piel de la oreja, siguiendo las indicaciones

CUANDO IMPLANTAR COMPUDOSE

En Bovinos para carne en etapa de novillos cuando son castrados o después.

En Bovinos para carne en pastoreo en crecimiento en el destete o después.


En Bovinos para carne en etapa de engorda/ engorde cuando llegan al corral.

ADVERTENCIAS

No se use en animales destinados a la reproducción. No se deje al alcance de los niños. No ingerir alimentos ó bebidas mientras se esté manipulando el producto. No utilizar en terneros para carne de ternera. Tiene un efecto de 200 días. Consérvese en un lugar fresco y seco. Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

EQUIPO:

Debe usarse un implantador de COMPUDOSE para implantar a los animales. Su distribuidor de COMPUDOSE tiene los implantadores y las agujas de repuesto.

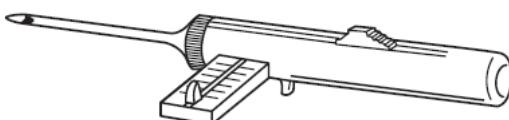

Implantador de COMPUDOSE

NSTRUCCIONES PARA IMPLANTAR:

1. Inmovilice al animal en la manga, prensa o por otros medios.
2. Para reducir la posibilidad de infección y evitar así que el implante se pierda, deberán tenerse cuidados higiénicos y de desinfección al implantar. La oreja debe estar limpia y seca. La piel debe limpiarse con alguna solución antiséptica como alcohol, antes de implantar. Esto es muy importante principalmente si las orejas están sucias con orina o excremento. Use una aguj con buen filo. Para reducir la posible transmisión de enfermedades o de infecciones locales, que resulte en la pérdida del implante, la aguja

deberá estar limpia y deberá también desinfectarse con un algodón embebido en alcohol antes de efectuar cada implantación. La presencia de excesiva humedad dentro de la aguja puede ocasionar que la Oxitetraciclina (OTC) en la superficie del implante se disuelva y se acumule dentro de la aguja.

3. Para cargar el implantador COMPUDOSE, jale el pasador hacia atrás, quite la cubierta protectora del cartucho e inserte el implantador (figura 1). Empuje el pasador hacia adelante hasta que el implante se ubique en el cilindro de la aguja (el primer sonido "clic" del implantador) como preparación para el implante. Para cargar implantes adicionales, jale el pasador hacia atrás y entonces empuje hacia delante el botón sobre el cartucho hasta la próxima posición.

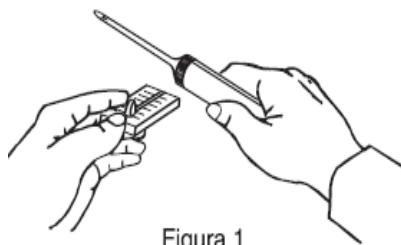


Figura 1

4. El implante debe ser colocado debajo de la piel en la parte posterior del tercio medio de la oreja (figura 2) Agarrando la punta de la oreja con una mano y con la otra el implantador, penetre la piel de la parte posterior de la oreja aproximadamente entre el tercio externo y el tercio medio de la oreja (figura 3). IMPORTANTE. No se debe penetrar el cartílago.

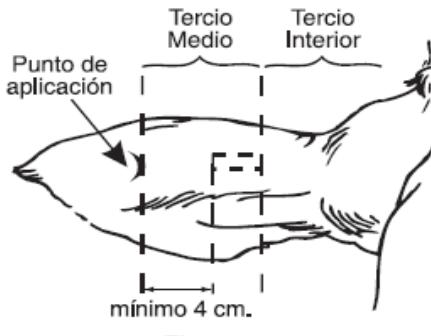


Figura 2

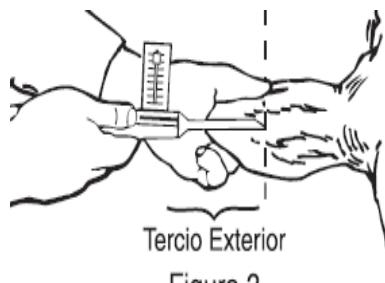


Figura 3

5. Apenas la aguja penetre, la misma debe ser completamente insertada (figura 4) entre la piel y el cartílago, evitando los conductos sanguíneos principales. Es importante la completa inserción de la aguja para asegurar la retención del implante.

6. Saque la aguja lentamente mientras el implante está siendo colocado empujando hacia delante el pasador (figura 5). Mantenga el pasador presionado a medida que va retirando la aguja de la oreja.

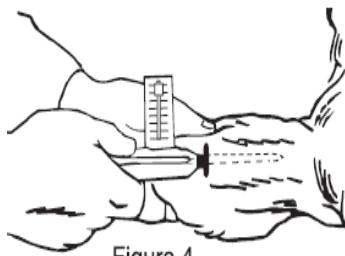


Figura 4

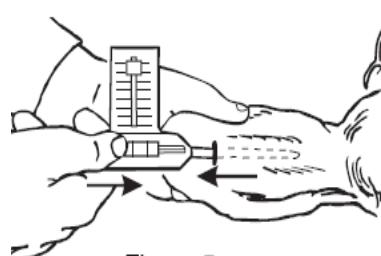


Figura 5

7. Limpie a fondo la pistola implantadora frecuentemente. Despues de varios usos, cantidades suficientes de Oxitetraciclina del implante pueden acumularse dentro de la aguja e impedir el paso del implante. Cambios periódicos de la aguja del implantador y lavado de la misma con agua evitarán tal acumulación. Antes de volver a usarla, la aguja deberá de ser desinfectada y secada agitándola vigorosamente para eliminar cualquier exceso de agua o desinfectante. 8. En áreas donde los ectoparásitos son endémicos, aplique el repelente apropiado al área donde se hizo la inserción.

PRECAUCION: Fallas en los procedimientos antisépticos al implantar, particularmente cuando las orejas están mojadas o contaminadas con materia fecal o cuando se bañan los animales en soluciones contaminadas, puede resultar en infecciones y pérdidas de implantes.

TIEMPO DE RETIRO:

No se requiere periodo de retiro antes del sacrificio

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

Elanco Salud Animal S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,

Piso 18, Col. Puerta de Hierro,

Zapopan C.P. 45116, Jalisco.

Tel.: 800 288 5553

Compudose 400

Reg. Q-0715-138

Implante anabólico de liberación controlada para su uso en Novillos, Toros y Vaquillas

FÓRMULA

Cada (implante) dosis equivale a:

Estradiol..... 43.9 mg

Oxitetraciclina..... 0.5mg

FORMA FARMACÉUTICA: Implante anabólico

INGREDIENTE ACTIVO: Estradiol y Oxitetraciclina

INDICACIONES: Implante de liberación controlada, para incrementar la tasa de ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia en novillos, toros y vaquillas de engorda / engorde en pastoreo y confinamiento (feed lots).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Cada implante de Compudose 400 de liberación controlada proveerá una dosis diaria efectiva de estradiol durante por lo menos 400 días en novillos, toros y vaquillas para engorda/engorde. Compudose 400, únicamente para implantación subcutánea en la oreja de bovinos para carne (Novillos, Toros y Vaquillas en pastoreo y confinamiento).

INSTRUCCIONES:

Inserte un implante debajo de la piel de la oreja, siguiendo las indicaciones

CUANDO IMPLANTAR COMPUDOSE

En Bovinos para carne en etapa de novillos cuando son castrados o después.

En Bovinos para carne en pastoreo en crecimiento en el destete o después.


En Bovinos para carne en etapa de engorda/ engorde cuando llegan al corral.

ADVERTENCIAS

No se use en animales destinados a la reproducción. No ingerir alimentos ó bebidas mientras se esté manipulando el producto. No utilizar en terneros para carne de ternera. Tiene un efecto de 400 días. Consérvese en un lugar fresco y seco. Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

EQUIPO:

Debe usarse un implantador de COMPUDOSE para implantar a los animales. Su distribuidor de COMPUDOSE tiene los implantadores y las agujas de repuesto.

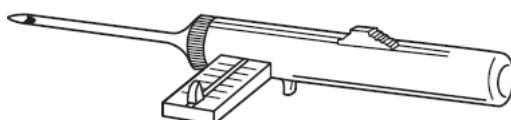

Implantador de COMPUDOSE

INSTRUCCIONES PARA IMPLANTAR:

1. Inmovilice al animal en la manga, prensa o por otros medios.
2. Para reducir la posibilidad de infección y evitar así que el implante se pierda, deberán tenerse cuidados higiénicos y de desinfección al implantar. La oreja debe estar limpia y seca. La piel debe limpiarse con alguna solución antiséptica como alcohol, antes de implantar. Esto es muy importante principalmente si las orejas están sucias con orina o excremento. Use una aguj con buen filo. Para reducir la posible transmisión de enfermedades o de infecciones locales, que resulte en la pérdida del implante, la aguja

deberá estar limpia y deberá también desinfectarse con un algodónembebido en alcohol antes de efectuar cada implantación. La presencia de excesiva humedad dentro de la aguja puede ocasionar que la Oxitetraciclina (OTC) en la superficie del implante se disuelva y se acumule dentro de la aguja.

3. Para cargar el implantador COMPUDOSE, jale el pasador hacia atrás, quite la cubierta protectora del cartucho e inserte el implantador (figura 1). Empuje el pasador hacia adelante hasta que el implante se ubique en el cilindro de la aguja (el primer sonido "clic" del implantador) como preparación para el implante. Para cargar implantes adicionales, jale el pasador hacia atrás y entonces empuje hacia delante el botón sobre el cartucho hasta la próxima posición.

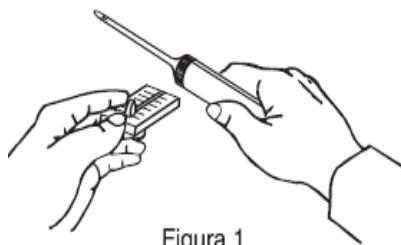


Figura 1

4. El implante debe ser colocado debajo de la piel en la parte posterior del tercio medio de la oreja (figura 2) Agarrando la punta de la oreja con una mano y con la otra el implantador, penetre la piel de la parte posterior de la oreja aproximadamente entre el tercio externo y el tercio medio de la oreja (figura 3). IMPORTANTE. No se debe penetrar el cartílago.

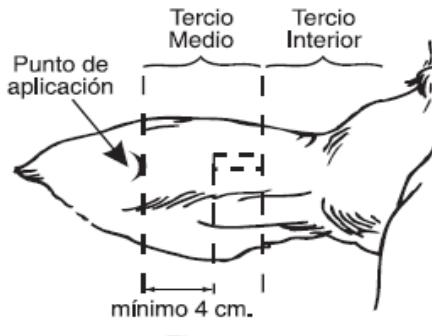


Figura 2

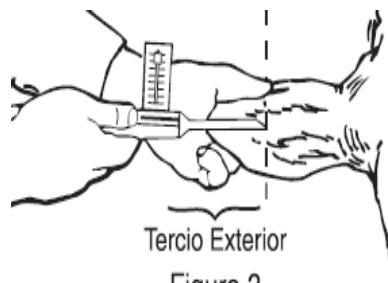


Figura 3

5. Apenas la aguja penetre, la misma debe ser completamente insertada (figura 4) entre la piel y el cartílago, evitando los conductos sanguíneos principales. Es importante la completa inserción de la aguja para asegurar la retención del implante.

6. Saque la aguja lentamente mientras el implante está siendo colocado empujando hacia delante el pasador (figura 5). Mantenga el pasador presionado a medida que va retirando la aguja de la oreja.

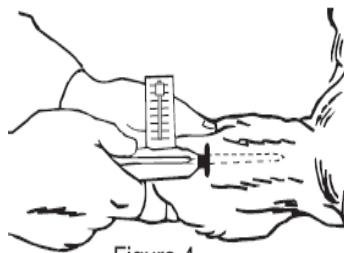


Figura 4

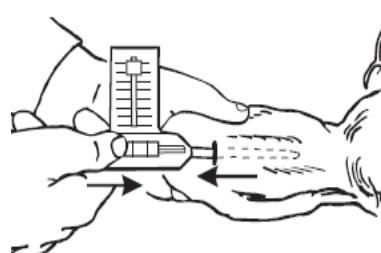


Figura 5

7. Limpie a fondo la pistola implantadora frecuentemente. Despues de varios usos, cantidades suficientes de Oxitetraciclina del implante pueden acumularse dentro de la aguja e impedir el paso del implante. Cambios periódicos de la aguja del implantador y lavado de la misma con agua evitarán tal acumulación. Antes de volver a usarla, la aguja deberá de ser desinfectada y secada agitándola vigorosamente para eliminar cualquier exceso de agua o desinfectante. 8. En áreas donde los ectoparásitos son endémicos, aplique el repelente apropiado al área donde se hizo la inserción.

PRECAUCION: Fallas en los procedimientos antisépticos al implantar, particularmente cuando las orejas están mojadas o contaminadas con materia fecal o cuando se bañan los animales en soluciones contaminadas, puede resultar en infecciones y pérdidas de implantes.

TIEMPO DE RETIRO:

No se requiere periodo de retiro antes del sacrificio

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

Elanco Salud Animal S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,

Piso 18, Col. Puerta de Hierro,

Zapopan C.P. 45116, Jalisco.

Tel.: 800 288 5553